


Недоступен ни один перевод.

Программный крио замораживатель плазмы крови и биоматериалов УТИ ТХ-2/+40...-80. □

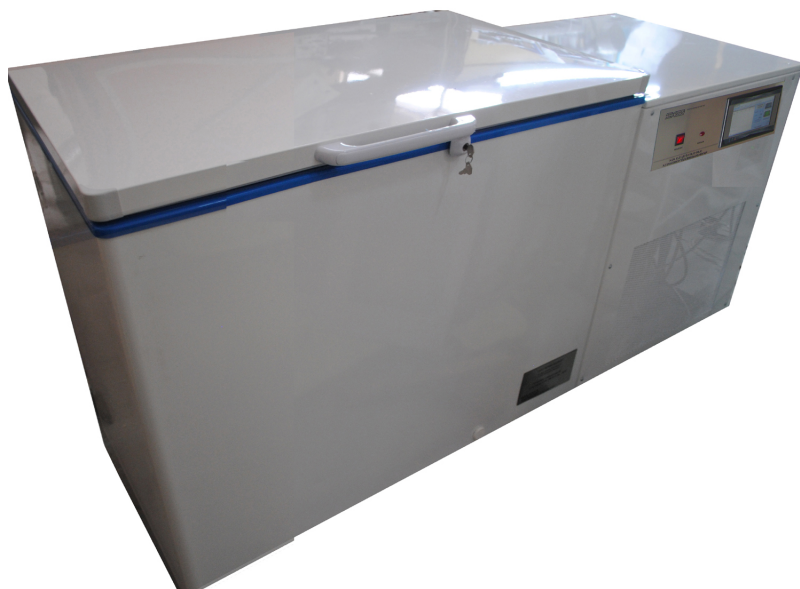

ООО «КРИО ХОЛОД» предлагает Вам программный крио замораживатель плазмы крови и биоматериалов УТИ 20-ТХ-2/+40...-80 для проведения технологического криогенного консервирования материалов. Установка работает в автоматическом режиме за исключением операции загрузки и выгрузки материалов.

Установка выполнена объемом 20 литров и температурой внутри камеры от плюс 40°C до минус 80°C, выпускаемая в соответствии с техническими условиями ТУ У 13674585-001-96.

Холодильная камера изготовлена по типу «лари», проста и удобна в эксплуатации. Внутренняя камера изготовлена из нержавеющей стали.

Установка оснащена контролером и сенсорной панелью, что позволяет осуществлять цифровую и графическую визуализацию режима работы установки,

регистрировать и сохранять эти данные. Сенсорная панель дает возможность полного управления установкой, задавая метод проведения заморозки (программы может быть строго по технологическому процессу и с задаваемыми параметрами скорости замораживания и конечной температуры замораживания).

Технические характеристики УТИ 20-ТХ-2/+40...-80

Характеристика

Ед. изм.

Значение

Полезный объем камеры $\pm 10\%$

дм ³

По запросу

Рабочая температура

°C

от плюс 40 до минус 80

Точность поддержания температуры

°C

±	0,5
---	-----

Скорость охлаждения до заданной температуры криогенного консервирования

от 3 до 60 град./час

в диапазоне до минус 80

до 30 град./час

в диапазоне от минус 80 до минус 135

Питание установки от сети переменного тока

В

380

Максимальная потребляемая мощность, до

кВт

~7

Масса установки, до

кг.

300

